


# In **weniger** Schritten zum Ziel!

Anleitung für NovoSeven®  
mit vorgefüllter Spritze





# Überblick – NovoSeven® mit vorgefüllter Spritze

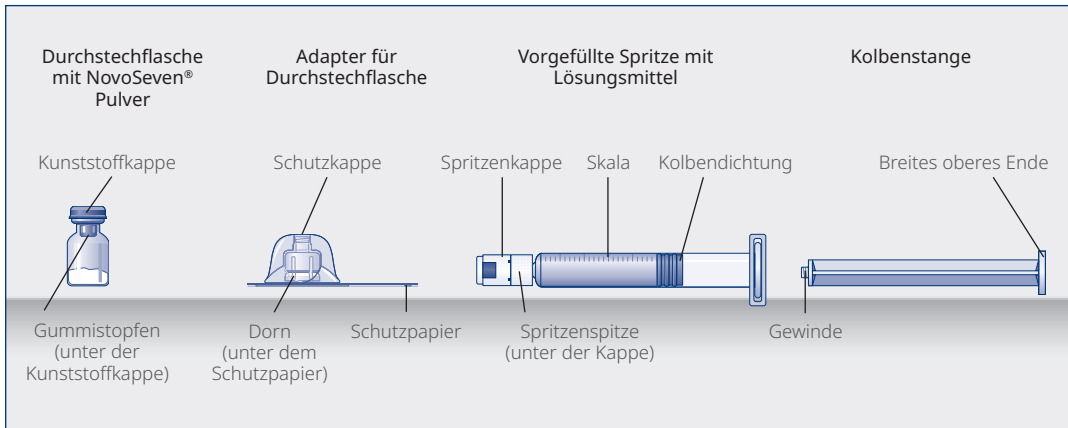




# Vorbereitung der Medikation



Prüfen Sie Verfallsdatum, Name und Dosis jeder NovoSeven® Packung.

**i** Waschen Sie die Hände, bevor Sie die Umverpackung öffnen.

Sind die Durchstechflasche und die vorgefüllte Spritze kalt, erwärmen Sie diese mit Ihren Händen (nicht über 37°C).

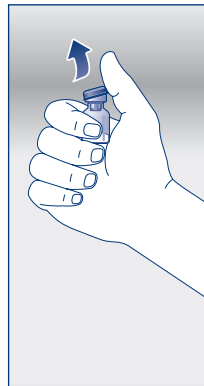


Entfernen Sie die Kunststoffkappe von der Durchstechflasche.

Verwenden Sie diese nicht, wenn die Kunststoffkappe locker ist oder fehlt.

Reinigen Sie den Gummistopfen mit einem Alkoholtupfer und lassen Sie ihn trocknen.




## Anbringen des Adapters

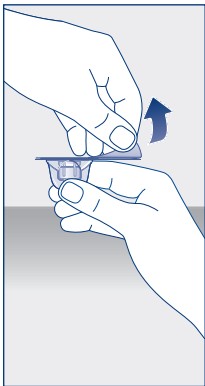

Entfernen Sie das Schutzpapier, um die Schutzkappe des Adapters zu öffnen.

Verwenden Sie diesen nicht, wenn das Schutzpapier nicht vollständig versiegelt oder es beschädigt ist.

**i** Berühren Sie den Adapter nicht, damit er steril bleibt.

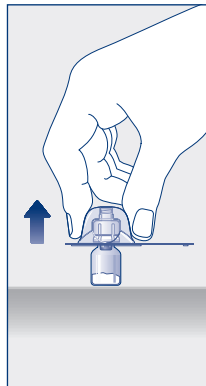


Drehen Sie die Schutzkappe um und lassen Sie den Adapter an der Durchstechflasche einrasten.

Drücken Sie die Kappe vorsichtig zusammen, um sie zu entfernen.

**i** Ist der Adapter einmal an der Flasche befestigt, sollten Sie ihn nicht mehr entfernen.



## Verbinden von Spritze und Kolbenstange

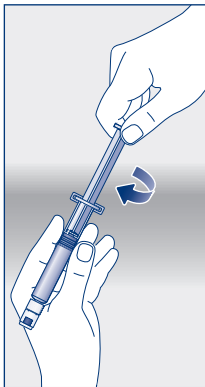


Fassen Sie die Kolbenstange am breiten oberen Ende an.

Schrauben Sie die Kolbenstange in die Spritze ein, bis ein Widerstand fühlbar ist.


Drehen Sie diese im Uhrzeigersinn, bis die Stange fest auf der Kolbendichtung sitzt

**i** Vermeiden Sie es, die Seiten oder das Gewinde der Kolbenstange zu berühren.



Entfernen Sie die Spritzenkappe, indem Sie die Kappe an der Perforierung abknicken, bis sie bricht.


**i** Berühren Sie keinesfalls die Spritzenspitze unter der Kappe.




Schrauben Sie die vorgefüllte Spritze im Uhrzeigersinn vorsichtig auf den Adapter, bis diese fest sitzt.



## Mischen von Pulver und Lösungsmittel



Halten Sie die Spritze schräg, drücken Sie die Kolbenstange vorsichtig herunter, um das Lösungsmittel vollständig in die Durchstechflasche zu injizieren.

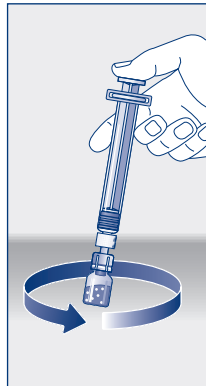


Lassen Sie die Kolbenstange heruntergedrückt und schwenken Sie die Flasche leicht im Kreis (Flasche nicht schütteln), bis sich das Pulver vollständig aufgelöst hat.

**i** Verwerfen Sie die Lösung, wenn sie sichtbare Partikel enthält oder nicht klar und farblos ist.




## Mischen von Pulver und Lösungsmittel (Fortsetzung)

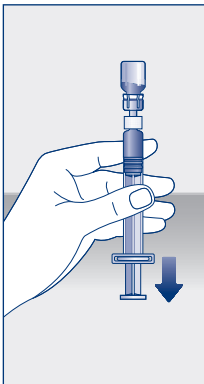


Drehen Sie nun die Spritze um. Lassen Sie die Kolbenstange los, damit die Lösung in die Spritze läuft. Ziehen Sie die Lösung mit der Kolbenstange in die Spritze auf.

Tippen Sie leicht an die Spritze, während Sie die Durchstechflasche auf den Kopf gedreht halten, um jegliche Luftblasen an die Oberfläche aufsteigen zu lassen.



Drücken Sie die Kolbenstange langsam nach oben, so dass die Spritze keine Luft mehr enthält.



Schrauben Sie den Adapter von der Spritze ab.



❗ Verabreichen Sie NovoSeven® intravenös über eine Zeitdauer von 2 bis 5 Minuten.

❗ Mischen Sie NovoSeven® niemals mit anderen intravenösen Infusionen oder Medikamenten.

❗ Verbrauchen Sie den gesamten Spritzeninhalt auf einmal. Wenn Sie nicht die gesamte angemischte Menge verbrauchen, lesen Sie bezüglich der Haltbarkeit die Hinweise in der Packungsbeilage.

❗ Entsorgen Sie die Spritze, den Adapter, die Durchstechflaschen, das Injektionszubehör sowie etwaige Produktreste ordnungsgemäß.

❗ Nehmen Sie die gebrauchten Materialien nicht auseinander, bevor Sie sie entsorgen.

❗ Gebrauchte Materialien nicht wiederverwenden.

Falls Sie den Inhalt mehrerer Durchstechflaschen in einer großen Spritze zusammenführen möchten, holen Sie bitte vorher fachkundigen Rat in Ihrem Hämophiliezentrum ein.







# Arzneimittelpackung: NovoSeven® mit vorgefüllter Spritze

Durchstech-  
flaschen

1 mg



2 mg



5 mg



Adapter für  
Durchstech-  
flasche

Sterile (Klasse 1) Einweg-Verbindung zum Flüssigkeitstransfer (25 µm Inline-Partikel-Filter, Luer-Lock-Verbindung)



Die Spritze enthält  
1 ml Lösungsmittel.



Die Spritze enthält  
2 ml Lösungsmittel.



Die Spritze enthält  
5 ml Lösungsmittel.

Vorgefüllte  
Spritze mit  
Lösungsmittel

**3-ml-Glasspritze**

(Kolbendichtung aus Gummi, einfach  
einsetzbare Kunststoff-Kolbenstange)

**10-ml-Glasspritze**

(Kolbendichtung aus Gummi, einfach  
einsetzbare Kunststoff-Kolbenstange)



# Injektionszubehör für NovoSeven®

**1 x Flügelkanüle  
mit Schlauch**



Steriles Injektions-Set  
mit integriertem  
Nadelschutz  
(25G mit  
35 cm Schlauch)

**2 x Alkoholtupfer**



Sterile Alkoholtupfer  
zur Reinigung von  
Durchstechflasche  
und Hautoberfläche

**2 x Pflaster**



Sterile latexfreie  
Heftpflaster

**2 x Mulltupfer**



Sterile Mulltupfer  
zum Schutz/zur  
Reinigung der Wunde



**Unser Ziel ist es, dass NovoSeven® und unsere Services Sie bei all Ihren Aktivitäten unterstützen. Wenn Sie Fragen oder Anregungen dazu haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:**

**☎ 06131 903 1133** (zum deutschen Festnetztarif)

**@ KD\_Service@novonordisk.com**



**Besuchen Sie auch unsere Website  
für Menschen mit Hämophilie: [haemcare.de](https://haemcare.de)**

Quelle: NovoSeven® Gebrauchsinformation, Stand Mai 2022.

**Novo Nordisk Pharma GmbH, Mainz**

Tel.: 06131 903 0, Fax: 06131 903 1370, [novonordisk.de](https://novonordisk.de)

NovoSeven® ist eine eingetragene Marke der Novo Nordisk Health Care AG und der Apis-Stier ist eine eingetragene Marke von Novo Nordisk A/S. © 2025 Novo Nordisk Health Care AG, Zürich, Schweiz.

DE25NS00001

